



■ 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙 [별표 9]


제어소 방어벽의 배치구조(별표 2의 제1호다목2)가) 관련)

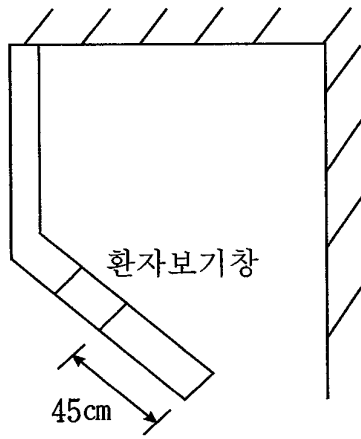


(환자보기창이 꺾여진 면에 있는 경우)

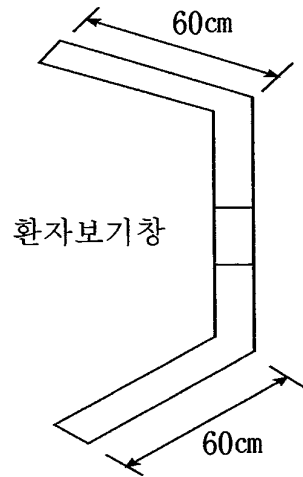

(환자보기창이 정면에 있는 경우)

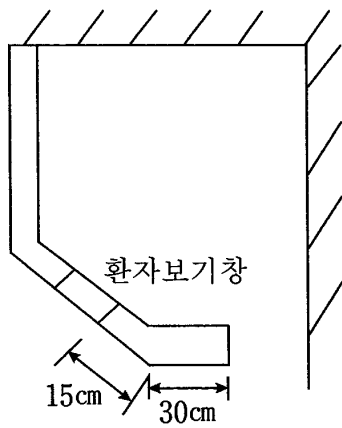

(환자보기창이 꺾여진 면에 있는 경우)

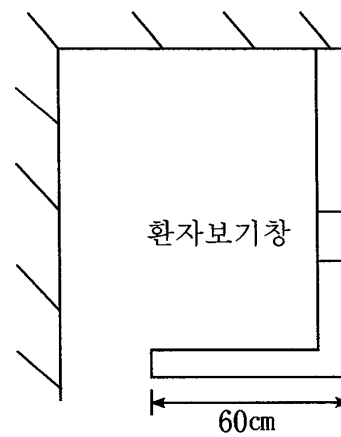

(환자보기창이 정면에 있는 경우)